
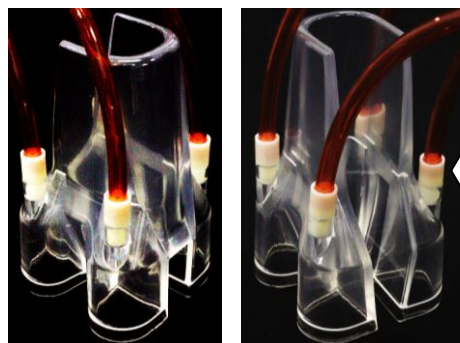


製品説明 安全な注射のための装置です。

超音波探触子は皮膚に圧着して使用します。
 静脈がつぶれて注射困難になり、動脈を誤穿刺することがあります。

現状の探触子

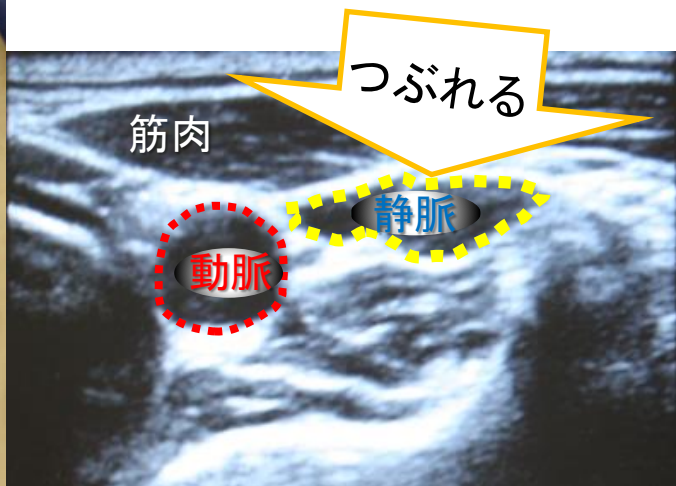

この装置は、吸引することで
 皮膚を引き上げながら、
 探触子を圧着することが可能で、
 静脈をつぶさず、安全な注射が出来ます。
 (国際特許出願済PCT/JP2014/58740)

探触子と補助装置

